

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

Dotari: Lift Targa

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>Hidraulic de persoane si targa</p> <p>Sarcina nominală 1600 Kg/ 21 persoane Viteza nominală, actionare 0.5 m/s, HAI 1:2</p> <p>Cursă 10,000 mm</p> <p>Număr stații/accese puț 4/4</p> <p>Număr accese cabină 1</p> <p>Lățime x adâncime puț 2000 mm x 2800 mm</p> <p>Înălțimea de siguranță inferioară 1400 mm</p> <p>Înălțimea de siguranță superioară 3600 m</p> <p>Lățime x adâncime x înălțime cabină 1400 mm x 2400 mm x 2100 mm</p> <p>Tip puț: Beton</p> <p>Camera mașinilor/poziționare motor 1500 mm x 1500 mm x 2000 mm/lateral de put</p> <p>Uși cabină/palier 1000 mm x 2000 mm Gol necesar uși 1280 mm x 2300 mm Acționare uși Automată cu viteză variabilă, cu reglare electronică a vitezei de închidere și limitator de forță la închidere, protecție obstacole</p> <p>de tip perdea (fotocortină pe toată înălțimea și lățimea ușii)</p> <p>Deschidere uși Laterală în 2 foi Finisaj ușă palier</p> <p>Inox satinat rezistente la foc 120 min conform E -120 E81-58</p> <p>cu prag de aluminiu standard</p> <p>Finisaj ușă cabină</p> <p>Inox satinat cu prag de aluminiu standard</p> <p>Tablou de comandă (controller)</p> <p>Cu microprocesor (fara blocarea instalatiei cu parola),</p> <p>tablou electric, acționare colectiv în jos, sistem de emergenta automat</p> <p>Motor 20 kW, 380 V, 50Hz consum doar la urcare</p> <p>Curent nominal/pornire A/A</p> <p>Panou comanda cabină AKC BES , inox satinat, butoane cu halou luminos, sistem de</p>		

	<p>iluminat de siguranță în cabina, afișor poziție și sens, sistem bidirecțional de comunicare Klemafon2, dispozitiv de alarmă cu telefon, linie analogică asigurată de beneficiar</p> <p>Panou comanda palier</p> <p>Buton cu halou luminos incadrat in toc cu afisor.</p> <p>Cabina MODERN LIFE L 310</p> <p>Perete spate Inox satinta + 1/2 Oglindă + mâna curentă inox K4 Perete stânga Inox satinat</p> <p>Perete dreapta Inox satinat + panou de comandă</p> <p>Podea Covor cauciuc griffon 6768</p> <p>Plafon Inox cu plexiglass 010 cu LED Dotări</p> <p>Sistem detectare obstacole Perdea cu fotocelule pe toată înălțimea și lățimea ușii (fotocortină 2D)</p> <p>Sistem de urgență: Inclusă, cu aducerea liftului la stația de bază și evacuarea pasagerilor în cazul căderilor de tensiune</p> <p>Scară acces fundătură: Inclusă Alarmă Pe cabină</p> <p>Iluminat puț inclus</p> <p>Iluminat de urgență cabină Inclus în panoul de comandă</p> <p>Interfon Sistem bidirecțional de comunicare Klemafon2</p> <p>Control suprasarcină Integrat în panoul de comandă</p> <p>Mediu funcționare Normal, (min +5°C /max +40°C)</p> <p>Certificări Conform Directiva 33/2014/EU, EN 81.20 + A3</p> <p>Nr. buc. : 1</p>		
2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p> <p>SERVICE IN POSTGARANTIE Durata: minimum 5 ani.</p>		

5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> - Denumirea; - Intreprinderea producatoare; - Anul fabricatie; - Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		
---	---	--	--

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

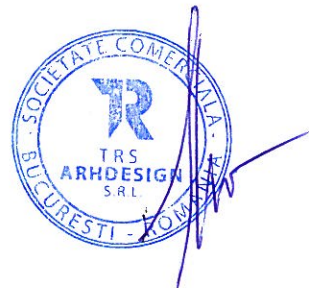
FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Dotari: Platforma persoane cu dizabilitati

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Cursa 5.13 m Tip scară dreaptă Sarcina <35° 230 kg Sarcina <45° 190 kg Viteza = 6 m/min Lățime x adâncime Tensiune = 800 mm x 700 mm Alimentare = 220 VAC, 24 VDC Motor 1kW Acționare Pinion și cremalieră Dotări Închidere/deschidere Automată Comandă Pushbuton Telecomandă Inclusă Bare de protecție Motorizate Sistem de urgență Acumulatori pentru funcționare la întreruperea tensiunii electrice Dispozitiv de limitare a vitezei Inclus Sisteme anti-strivire Inclus Culoare RAL 9010 Certificari EN81/40</p> <p>Nr. Buc. : 1</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	Conditii de garantie si postgarantie:		

	Garantie 24 luni . SERVICE IN POSTGARANTIE Durata: minimum 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: Denumirea; Intreprinderea producatoare; Anul fabricatie; Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,



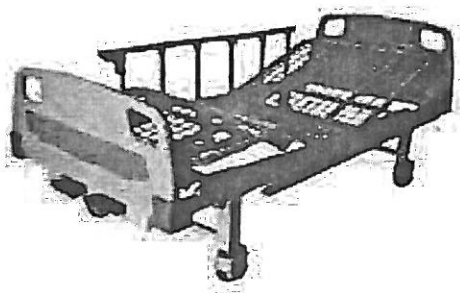
PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 3

Dotari mobilier: Pat de spital mecanic cu 2 sectiuni ajustabile

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2100 x 1000 x 500 mm, - platforma saltea cu 4 sectiuni din plasa de sarma, - structura metalica, - 4 roti din care 2 cu frana, - doua manivele pliabile pentru ajustare spate si picioare, - laterale din aluminiu cu buton de deblocare, - panouri cap/picioare din plastic, - greutate maxima sustinuta 150 kg <p>Nr. Buc. 6</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde		

	relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> - Denumirea; - Intreprinderea producatoare; - Anul fabricatie; - Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

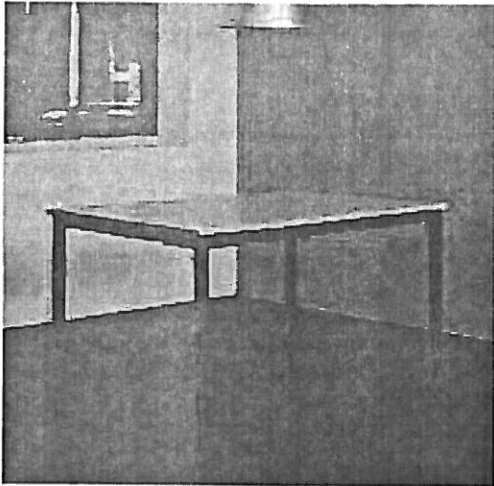


FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Dotari mobilier - Masa tip 1

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: Masa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L 80 x l 80 x h 74,5cm - structura metalica vopsita electrostatic culoare negru - blat termorezistent culoare bej (ral 1015) grosime 22mm <p>Nr. buc. : 1</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		

4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,



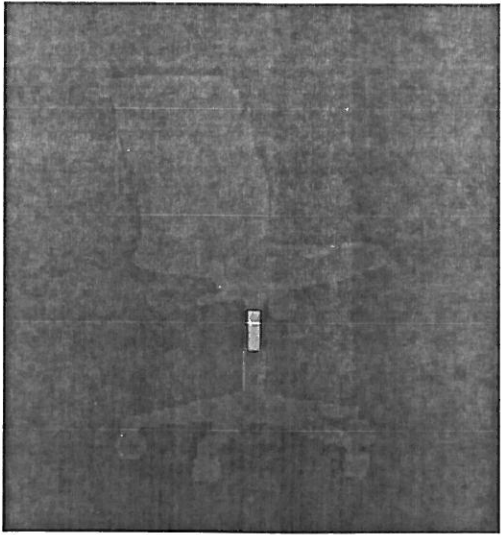
PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 5

Dotari mobilier - Scaun cu rotile

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: - L61xl61xh105cm piele ecologica, culoare neagra - spatar rabatabil mecanism sincron, - ajustabilitatea inaltimii - baza mobila structura metalica Nr. buc. : 18</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		

4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



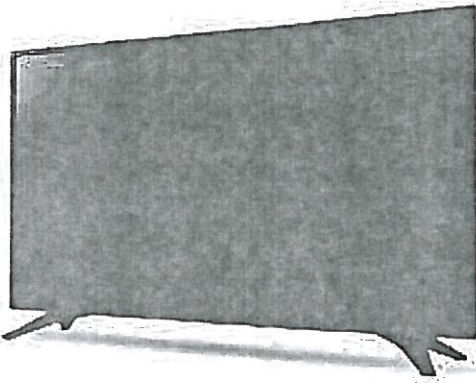
FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6

Dotari - Televizor

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagonala 80cm (32") - Dimensiuni (W x H x D) cu stand: 733 x 483 x 170 mm - Greutate (Kg): 5.5 - Compatibil VESA: 200x200 <p>Caracteristici generale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip display: LED - Tip TV: Non Smart TV - Functie monitor: Da - Culoare: Negru - Material: Plastic ABS <p>Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem audio: Stereo - Iesire sunet (RMS) 2x10W - Clear Voice - Virtual Surround <p>Video</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezolutie Full HD 1920x1080p - Aspect imagine 16:9 - Picture Mode - Active Noise Reduction - Dynamic Color Enhancer - PMI 900 <p>Tuner/Receptie/Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuner digital: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 - Redare video: Da - Intrare antena: Da <p>Caracteristici speciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Player multimedia integrat: Da <p>Conectori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiuni: <p>2 x RF In</p> <p>Slot CI+</p> <p>RS232C</p> <p>Intrare USB: 1</p> <p>Intrari component: 1</p> <p>Intrari Scart (RGB): 1</p> <p>Porturi HDMI: 2</p> <p>Accesorii incluse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telecomanda - Cablu alimentare 		

	<p>- Manual utilizare</p>  <p>Nr. Buc: 10</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

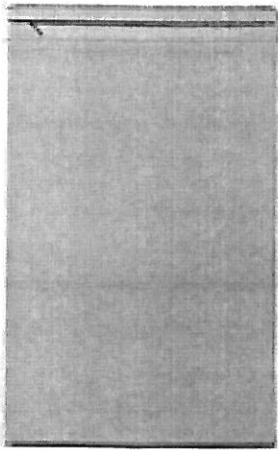
Proiectant,

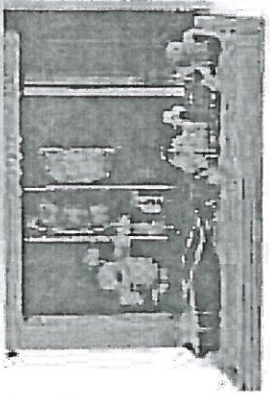


OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 7

Dotari - Frigider cu 1 usa

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: -HxLxA (mm) : 818x475x530 Caracteristici generale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frigider cu 1 usa - Volum net total (l): 86 l - Clasa energetica A+ - Numar rafturi: 2 - Numar suporturi usa: 3 - Compartiment legume/fructe: Da - Material rafturi: sticla cu margini de protectie - Deschidere standard: Dreapta - Usi reversibile: Da - Maner: orizontal - Lumină frigider: Bec LED - Culoare: Alb <p>Detalii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip control: manual cu termostat reglabil - Numar compresoare: 1 - Agent racire: R600a - Nivel zgomot: 43dB - Sistem dezghetare: Automat 		

	 <p>Nr. Buc. 10</p>		
2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie:</p> <p>Garantie 24 luni .</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

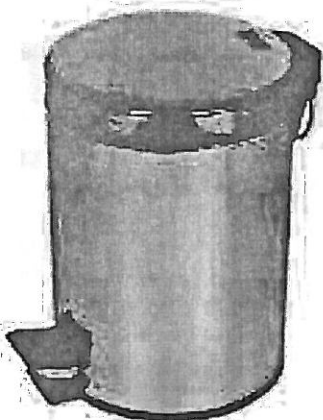
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 8

Dotari mobilier - Cos de gunoi


Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitate: 7 litri. - Forma: rotund - Material: otel inoxidabil - mecanism deschidere capac cu pedala - Culoare: argintiu <p>Nr. buc. : 15</p> 		
2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie:</p> <p>Garantie 24 luni .</p>		

5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		
---	---	--	--

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

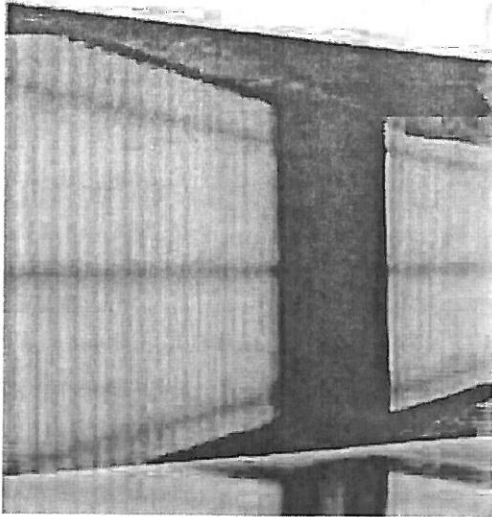


FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 9

Dotari – jaluzele verticale

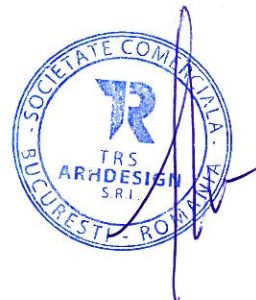
Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Tip jaluzele: -Cu lamele verticale din aluminiu Dimensiuni: - Latime lamele: 89mm - Dimensiuni LxH: Nr. Buc 1600x2800mm 10buc. 2400x2800mm 20buc. 1000x2800mm 20buc.</p> <p>Materiale: - Lamele: aluminiu, culoare crem (RAL 1015), opace - Sina: culoare alb</p>  <p>Nr. Buc: 12</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de</p>		

	folosire.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare;		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;




FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 10

Dotari mobilier - Masa consultare

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L 185 x l 60 x h 79cm - structura metalica Ø35 mm vopsita electrostatic culoare argintiu - saltea din poliuretan de densitate 25, inalta de 5 cm, diverse culori - husa saltea lavabila din material ignifug, usor de curatat - spatar reglabil in inaltime <p>Nr. buc. : 2</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		

4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .Granatie: 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;




FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr.11

Dotari mobilier - Cuier salon

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inaltime: 176 cm - Material: otel inoxidabil - Culoare: argintiu <p>Nr. buc. : 10</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p>		

5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		
---	---	--	--

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 12


Dotari – scaun tratament

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Nr. Buc 4		
2	Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare;		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;




FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 13

Dotari mobilier - Birou medic

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - birou L160x70x76cm, pal finisaj stejar cremona - grosime blat 36mm, cant ABS 2mm - structura fixa metalica culoare gri, 60x60, traverse 60x20 - pazie din PAL melaminat grosime 18mm culoare gri aluminiu  <p>- Nr. buc. : 7</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insolit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie:</p>		

	Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

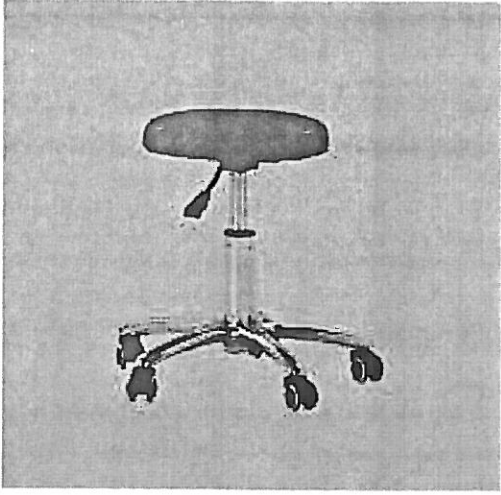
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 14

Dotari mobilier - Taburet ergonomic medic


Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inaltime reglabila: H 47 - 56cm - culoare negru - cadru aluminiu - ajustabilitatea inaltimii - greutate maxima 130kg - baza mobila cu 5 brate prevazute cu roti cu frana  <p>Nr. buc. : 7</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In</p>		

	conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

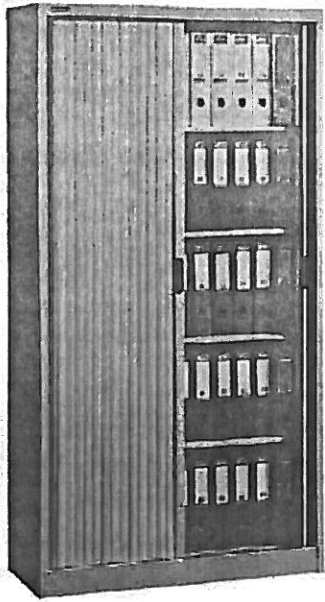


FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 15

Dotari mobilier - Dulap 3 usi 1950 x 1000 x 450mm

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1950 x 1000 x 450 mm, - Corp tabla de otel calitatea I vopsit electrostatic culoare gri (RAL7035) - Usi pliante din plastic - 4 rafturi - greutate 117 kg  <p>Nr. buc. : 8</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare;		

Proiectant,

PRECIZARE:

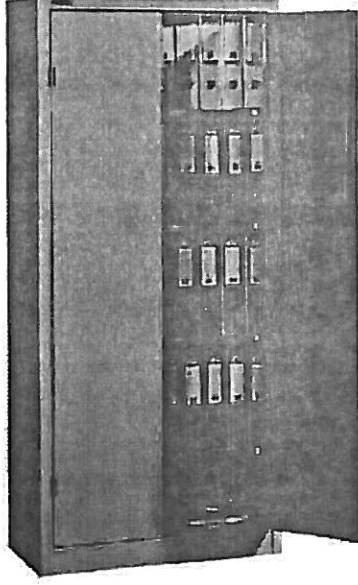
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti"

FIȘA TEHNICĂ Nr. 16

Dotari mobilier - Dulap tip fiset

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1800 x 800 x 400 mm, - Corp tabla de otel calitatea I vopsit electrostatic culoare gri (RAL7035) - Usi tabla de otel calitatea I vopsit electrostatic culoare bej (RAL1015) - 4 rafturi depozitare - greutate 38 kg  <p>Nr. buc. : 3</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p>		

	Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

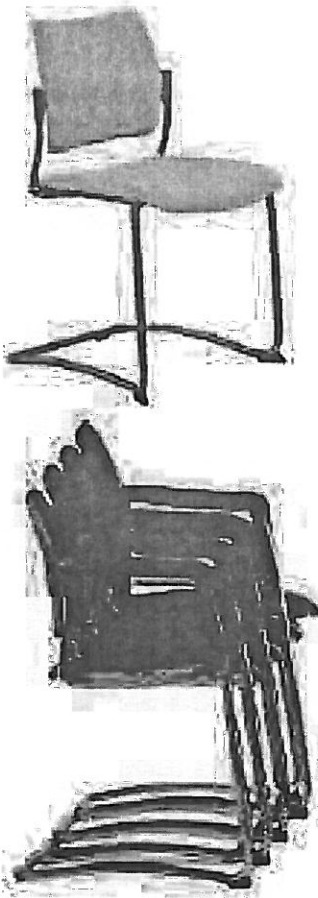
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 17

Dotari mobilier - Scaun pacienti

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - material: stofa. - latime totala 82cm - inaltime sezut 49cm - adancime totala 55cm - adancime sezut 47cm - latime totala 59cm - latime sezut 47 - greutate 6kg - cadru: metal vopsit electrostatic c gri - stocabil  <p>Nr. buc. : 40</p>		

2	Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare;		

Proiectant,

PRECIZARE:

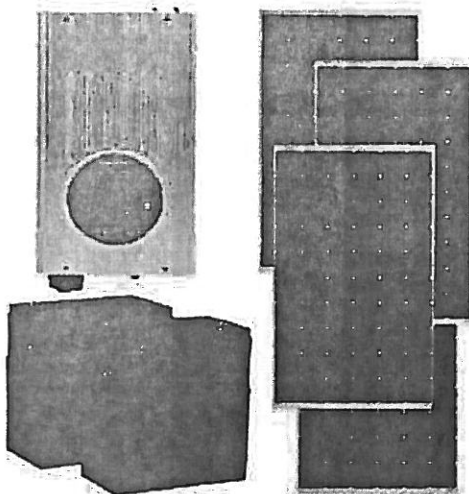
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 18

Dotari : Kit solar cu 4 panouri monocristaline

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 1657mm x 998mm x 38mm 18.1kg greutate: 130 kg Echipamente incluse: Panou solar 4buc Invertor 1 buc Baterie 2 buc</p>  <p>Nr. buc. : 3</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p> <p>Echipamentul va avea urmatoarea configuratie:</p>		

	<p>Caracteristici panou:</p> <p>Tip panou : monocristalin</p> <p>Putere: 250W</p> <p>Eficienta celule : 18.28%</p> <p>Tensiune maxima : 31.8 V</p> <p>Curent maxim : 8.32 A</p> <p>Tensiune circuit deschis: 38.16 V</p> <p>Curent de scurtcircuit : 9.06 A</p> <p>Celule solare: 60 (6x10)</p> <p>Cablu conectare 2x1, conector MC4</p> <p>Caracteristici baterie:</p> <p>Capacitate: 200Ah</p> <p>Tensiune nominala: 12 V</p> <p>Tip baterie: Gel</p> <p>Caracteristici inverter:</p> <p>Putere continua: 3000 W</p> <p>Putere maxim 90000 W</p> <p>Tensiune alimentare baterii 24V</p> <p>Tensiune de iesire RMS 220V/230V/240V AC (+/- 10%)</p> <p>Frecventa semnal de iesire 50Hz / 60Hz</p> <p>Eficienta inverter >88%</p> <p>Eficienta mod linie >95%</p> <p>Timp tipic de transfer 10ms (max)</p> <p>Tensiune intrare AC 96-132VAC 155-280VAC</p> <p>Tensiune minima de pornire 20.0VDC / 21VDC Alarma baterie scazuta 21.0VDC+/-0.6V Alarma baterie deconectata 20.0VDC+/-0.6V Alarma supratensiune 32.0VDC+/-0.6V</p> <p>Curent maxim incarcare AC 30 A</p> <p>Curent maxim incarcare solara 40 A</p> <p>Tensiune DC solara 100VDC</p> <p>Putere solara maxima 1200W</p> <p>Eficienta incarcare solara >90%</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie:</p> <p>Garantie 24 luni .</p> <p>SERVICE IN POSTGARANTIE Durata: minimum 5 ani.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa 		

	<p>aiba o eticheta care sa cuprinda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denumirea; - Intreprinderea producatoare; - Anul fabricatie; - Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		
--	--	--	--

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;




FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 19

Dotari: Kit panou solar apa calda

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Capacitate rezervor 216 l Recomandat pentru incaperi pana la 3.23 m Inaltime 1800 mm Lungime 58 mm</p> <p>Tip produs panou solar Tip panou solar termic Tip panou termic cu tuburi vidate Structura cu rezervor Numar tuburi 24 Material bazin inox</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire. Echipamentul va avea urmatoarea configuratie: 24 Tuburi de sticla vidate de tip termos (58mm X 1800mm); Boiler integral din inox (interior, exterior);</p>		

	Suport de fixare panou solar din inox; Vas asistent cu flotor 5 litri din inox; Elemente de fixare, accesorii, suruburi, piulite.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni . SERVICE IN POSTGARANTIE Durata: minimum 5 ani.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare;		

Proiectant



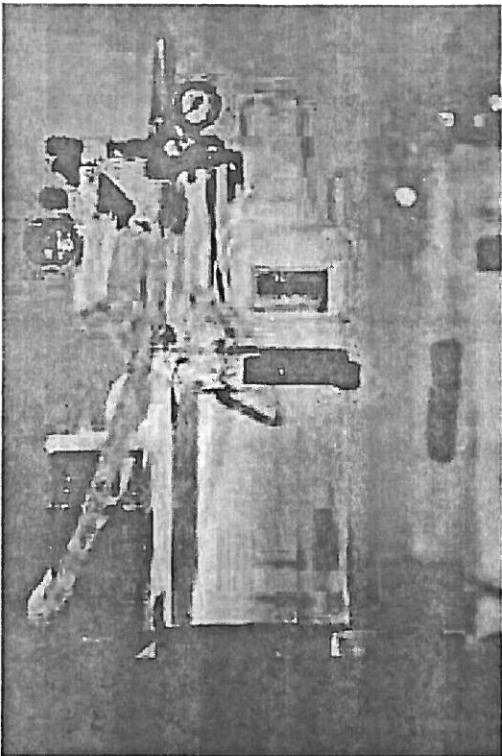
PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 20

Dotari: Unitate portabilă pentru oxigenoterapie


Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni: 335 x 140 x 620 mm greutate: 9 kg</p> 		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire. Echipamentul va avea urmatoarea configuratie: Reglarea debitului de ieșire al oxigenului: 0-15 l/min. Reglarea vacuumului: 0 ÷ -0.8 bar Debitul de aer aspirat: 15 l Capacitatea buteliei: 3 litri (450 litri de gaz la 150 bari) Presiunea de umplere a cilindrului: până la 200 bar</p>		

	<p>Timpul de golire al cilindrului: 7.5 ore, la un debit de ieșire constant de 1 l/min.</p> <p>Volumul umidificatorului: 300 ml sau 340 ml sau 500 ml sau 650 ml</p> <p>Volumul vasului de aspirație: 0.5 litri.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie:</p> <p>Garantie 24 luni .</p> <p>SERVICE IN POSTGARANTIE Durata: minimum 5 ani.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

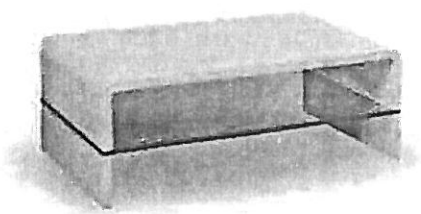


FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 21

Dotari: Masa vizitatori (zona de asteptare)

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Dimensiuni:</p> <p>Lungime: 110 cm, Latime: 60cm, Inaltime: 42 cm. Fabricata din MDF si sticla de calitate superioara.</p>  <p>Nr.buc: 5</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie</p>		

	24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

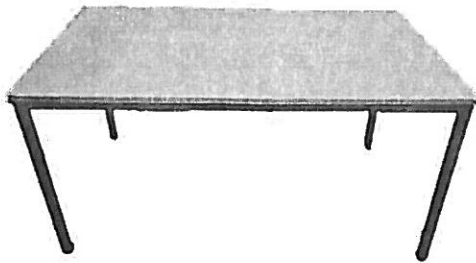


FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 22

Dotari: Masa birou CT

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Din PAL melaminat de culoare alba, picioare metalice, cu o usa pe o parte si 4 sertare pe alta parte.</p> <p>Atat usa cat si sertarele sunt incuiabile.</p> <p>Dimensiuni: 130x65x77cm</p>  <p>Nr.buc: 1</p>		
2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie</p>		

	24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

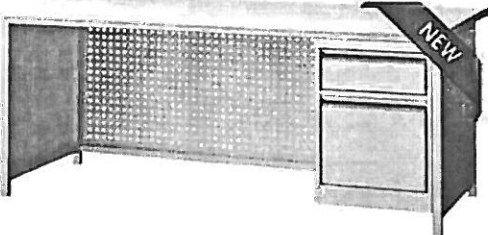


FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 23

Dotari: Birou accelerator (500x80)

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Constructie metalica sudata din profile 35x35x1,5 mm Dulap fix cu 2 sertare Dimensiunea placa de lucru: 1700x650 mm Grosime placa de lucru: 30 mm Material placa de lucru: PFL cu strat de melamina Vopsire: in camp electrostatic Culoarea: RAL 7035 Picioare: cu protectie din cauciuc Dimensiunea totala: 1700x650x750mm</p>  <p>Nr.buc: 2</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde		

	relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propușe de executantul lucrării și acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producătoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare;		

Proiectant,



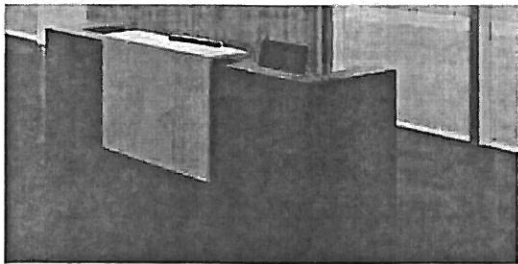
PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 24

Dotari: Ghiseu fisier (birou receptie)

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Mobilierul Giuletta păstrează un stil tradițional la care s-a adăugat o notă subtilă de modernism.</p> <p>Corpul compact și încăpător este completat stilistic de o piesă decorativă, ambele elemente fiind fabricate din PAL EGGER 18 si 36 mm grosime, cantuit cu ABS.</p> <p>Nuanța principală de lemn a fost desăvârșită cu detaliul alb perlat si prin utilizarea iluminarii LED pentru un contrast vizual de exceptie.</p> <p>Receptia Giuletta are in componenta sa doua corpuri, fiecare cu usa si sertar pentru depozitarea diverselor documente.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 2500 mm Adancime: 600 mm Inaltime blat lucru: 750 m Inaltime: 1100 mm</p>  <p>Nr.buc: 1</p>		
2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde		

	relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propane de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care sa asigure protectia la deteriorari mecanice si climatice (auto, feroviare) respectand normele in vigoare;		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;



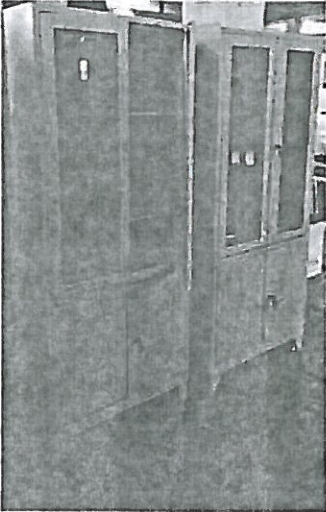
FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "


FIȘA TEHNICĂ Nr. 25

Dotari: Dulap medicamente

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>- Recomandat pentru utilizare comerciala si industriala.</p> <p>- Fabricat conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si acreditat de organismele internationale.</p> <p>- Fabricat din otel de inalta calitate cu grosimea de 0,7 mm.</p> <p>- Corpul fisetelor si dulapurilor este executat in constructie sudata.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>- dimensiuni gabarit 760x380x1660+100 mm LxIxH</p> <p>- executie dn tabla otel carbon, corp asamblat prin sudura</p> <p>- 2 usi Plexiglas/sticla in rama metal la partea superioara</p> <p>- 2 usi metal la partea inferioara</p> <p>- 2 polite la partea superioara</p> <p>- 1 polita la partea inferioara</p> <p>- politele sunt reglabile pe inaltime</p> <p>- greutate max/polita: 35 kg</p> <p>- usile de sticla/plexiglas si cele de metal sunt prevazute cu incuietori cu cate 2 chei fiecare</p> <p>- la baza este prevazut cu soclu H 70 mm si sub soclu cu picioare H 100 mm cu reglare pe inaltime, si terminatii de plastic pentru evitare coroziune</p> <p>- dulapul este vopsit in camp electrostatic, culoare gri deschis RAL 7035 txt sau alb RAL 9016 txt.</p> <p>Dotari optionale:</p> <p>*Polite suplimentare.</p> <p>*Culori la tema usi sau integral (minim 10 bucati comandate), conform paleta de culori atasata mai sus si conform: Gri RAL 7035txt (standard), Crem RAL1015txt, Orange RAL1028txt, Rosu RAL 3000txt, Albastru RAL5015txt, Verde RAL 6005txt, Gri inchis</p>		

	<p>RAL 7046txt, Maro RAL 8016txt, Negru RAL9005txt, Silver RAL 9006txt, Alb RAL9016txt.</p>  <p>Nr.buc: 2</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,




PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 26

Dotari: Dulap vestiar

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Caracteristici tehnice: Destinate depozitarii hainelor. Realizate din tabla decapata Corpul vestiarelor este o constructie sudata, usile sunt prevazute cu fante de aerisire si suport eticheta Inchiderea vestiarelor se realizeaza cu yala cilindrica cu 2 chei. Vestiarele sunt de tip cusetat, compartimentat si standard. Dotare vestiarele standard: 1 polita la partea superioara (sarcina utila max 10 kg) 1 bara umeras (sarcina utila max 10 kg) 1 carlig Dimensiuni produs: Latime 312mm Adancime 450mm Inaltime 1800mm</p>  <p>Nr.buc: 7</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie,</p>		

	insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001: 2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;




FORMULARUL F5

OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 27

Dotari: Bancheta vestiar


Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Banca vestiar simpla cu cuier si cu suport pantofi este fabricata din profile rectangulare de otel 45x45x3mm. Acestea sunt vopsite in 3 straturi pentru rezistenta sporita la uzura. Culoarea de baza este gri, la cerere si pentru cantitati mai mari de 6 ml bancile pot fi vopsite in orice alta culoare stabilita de comun acord.</p> <p>Latime totala 45 cm, inaltimea sezutului este de 45 cm, inaltimea totala 165 cm; Sezutul, spatarul si cuierul sunt din lemn de rasinoase lacuit in 2 straturi; Agatatorile sunt din metal, foarte rezistente, destinate traficului intens. Suportul de pantofi este din profile de metal rectangulare. Picioarele sunt prevazute cu dopuri din plastic speciale pentru a proteja pardoseala si pentru reglajul bancii.</p> <p>Pretul final se calculeaza in functie de dimensiunile bancii;</p> <p>Greutatea maxima suportata: 100kg/ml. Greutate proprie: aproximativ 18kg/ml. Lungimea maxima pentru o bucata 3,5 m.</p> <p>Banca vestiar simpla este construita in conformitate cu normele europene de calitate si de siguranta DIN7917.</p>		

	 <p>Nr.buc: 3</p>		
2	<p>Alte specificatii: Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului. Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

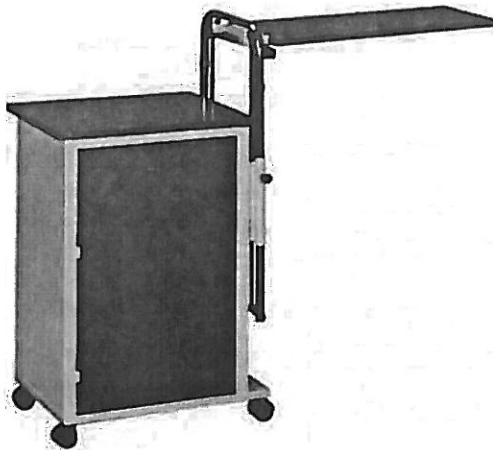
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 28

Dotari: Noptiera cu masa – pat spital

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Noptiera pat spital metalica cu masa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadru din metal. • Masa plianta este disponibilă în partea laterala. • Masa este fabricată din lemn. • Înălțimea mesei este reglabilă cu mecanism mecanic. • 1 un sertar. • 1 un dulap. • Patru roți pivotante de 360 de grade. • Toate piesele metalice sunt acoperite cu vopsea electrostatică. <p>Dimensiuni:</p> <p>Dimensiuni exterioare: 400 x 540 mm</p> <p>Înălțime: 820 mm</p> <p>Masa noptierei: 380 x 440 mm</p> <p>Masa pentru pat: 300 x 530 mm</p> <p>Reglarea înălțimii (masă): 780 – 1000 mm</p> <p>Diametrul roților: 50 mm</p> <p>Adâncime: 380mm</p>  <p>Nr.buc: 6</p>		
2			

	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;




OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 29

Dotari: Dulap metalic pentru ustensile curatenie


Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Dulap metalic obiecte curatenie AC60 cu picioare, 600x400x1920 mm, neasamblat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dulap ustensile curatenie, cu spatiu pentru mop si galeata / matura cu picioare • structura de rezistenta realizata din tabla de otel profilata de prima calitate, grosime 0,7 mm • usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea inferioara • oglinda in partea interioara a usi • nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita • porteticheta • sistem de inchidere sus-jos (in 3 puncte) • livrare in stare complet Neasamblata • incuietoare maner cu butuc si 2 chei • greutate maxima suportata de polita: 40 kg • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri • dimensiune: 600x400x1920 mm (Latime x Adancime x Inaltime) • prevazut cu picioare de 12 cm ce permit curatarea spatiului de sub dulap si evitarea ruginei • culoare: gri RAL 7035 • certificari: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • greutate 30 kg 		

			
	Nr.buc: 3		
2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:


Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;



OBIECTIV: "LABORATOR DE RADIOLOGIE – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti "

FIȘA TEHNICĂ Nr. 30

Dotari: Rafturi metalice documente arhiva

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> • fiset metalic fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm • utilizare comerciala si industriala • constructie sudata din otel cu pereti simpli • livrare in stare complet asamblata • prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime • sistem de inchidere sus-jos • incuietoare cu 2 chei • greutate maxima suportata de polita: 40 kg • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri • dimensiune: 800x350x1800 mm (Latime x Adancime x Inaltime) • culoare: gri RAL 7035 • certificari: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • greutate 39 kg • biblioraft-uri marmorate confectionate din carton rigid • mecanism metalic nichelat pentru prinderea documentelor • prevazut cu eticheta pe cotor • utilizate pentru clasarea documentelor • latime 8 cm • culoare: gri marmorat <p>cod: 98115020P</p>  <p>Nr.buc: 4</p>		

2	<p>Alte specificatii:</p> <p>Se vor prezenta obligatiile furnizorului privind transportul, manipularea, montajul si reglarea mobilierului.</p> <p>Predarea se va face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Sistemul de management al calitatii In conformitate cu ISO 9001: 2008</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni .</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conditiilor tehnice de calitate se va face pe baza unor metode propuse de executantul lucrarii si acceptate de beneficiar; - Fiecare echipament trebuie sa aiba o eticheta care sa cuprinda: <ul style="list-style-type: none"> · Denumirea; · Intreprinderea producatoare; · Anul fabricatie; · Seria fabricatie; - Transportul se va face cu mijloace care să asigure protecția la deteriorări mecanice și climatice (auto, feroviare) respectând normele în vigoare; 		

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1;

